

## Instructions for use SpecialNeeds™ Feeder

## Gebrauchsanweisung SpecialNeeds™ Sauger

## Mode d'emploi SpecialNeeds™ Tétine



### Intended use

The SpecialNeeds Feeder is intended to feed breast milk and other liquids of similar consistency to infants.

The Mini SpecialNeeds Feeder (Mini SNF) has the same intended use as the SpecialNeeds Feeder but for smaller or premature infants. The Mini SNF is only available for hospitals.

### Indications

The SpecialNeeds Feeder is indicated for use for infants with:

- I A weak condition such as low muscle tone;
- I Neurological, cardiac or respiratory disorders resulting in difficulties in coordinating sucking, swallowing and breathing;
- I Oral-facial anomalies such as cleft lip/palate or strong tongue-tie;
- I Pierre Robin Syndrome or Down Syndrome.

### Important safety information

**For the infants child safety and health – WARNING!**

- I Only use this product with adult supervision.
- I Do not warm liquid in a microwave oven as this may cause uneven heating and could scald the infant.

### Read all instructions before use

- I Use the product only for its intended use as described in this instruction manual.
- I Use by more than one infant without adequate reprocessing may present a health risk and could cause cross-contamination.
- I Use Medela original accessories only.
- I Inspect before each use. Throw away at the first signs of damage, mould or weakness.
- I Never leave packaging and components unattended. Keep them out of reach of children.

### SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL

### Important safeguards

- I Plastic bottles and component parts become brittle when frozen and may break when dropped.
- I Also, bottles and component parts may become damaged if mishandled, e.g. dropped, over-tightened, or knocked over.
- I Take appropriate care in handling bottles and components.
- I Don't use the liquid if bottles or components become damaged.

### Cleaning

#### Important

- I Only use drinking-quality water for cleaning.
- I Reprocess all parts prior to first use (see below).
- I Clean all parts immediately after use.
- I The cleaning instructions below are general instructions. For country-specific regulations and guidelines, ask your Medela agent or visit our website ([www.medela.com](http://www.medela.com)).

### After each use

- I Disassemble the feeder into its individual parts. Make sure to separate the yellow valve plate from the teat. Also separate the white membrane from the valve plate.

**Note:** You can re-use the milk that is left in the bottle. However, you must throw away the milk left in the teat. Therefore, hold the feeder above the sink. Carefully unscrew the lid and remove it together with the teat and valve plate, so as not to spill milk. Discard the leftover milk from the teat.

- I Rinse all parts with cold water (approx. 20 °C). Clean all parts with plenty of warm, soapy water (approx. 30 °C). Use a commercially available washing-up liquid, preferably without artificial fragrances and colouring (for hospital use: 5–15% anionic tenside, nonionic tenside, pH neutral). Rinse all parts with cold water (approx. 20 °C).
- I Dry with a clean cloth or leave to dry on a clean cloth.
- I Alternatively, clean the product in the dishwasher. Place the parts on the top rack or in the cutlery section. Use a commercially available dishwashing detergent.

### Home use:

- I Before first use and once a day
- I Clean the feeder as described under "After each use".
- I Disinfect the feeder as described under "Disinfection".

### Hospital use:

Before first use – once a day – before passing on to another infant

- I Clean and disinfect the feeder as described under "Disinfection".
- I If required by national, regional or in-house regulations, sterilise the feeder as described under "Sterilisation".

### Disinfection

#### Home use:

- I Cover all parts with water and boil for five minutes.
- I Or use a Quick Clean microwave bag in accordance with the instructions.

I Dry with a clean cloth or leave to dry on a clean cloth.

#### Hospital use:

- I Clean and disinfect all parts in a mechanical washer-disinfector. Use appropriate inserts for small parts. Use a common clearing detergent for washer-disinfectors (NTA-, phosphate-, chlorine- and tenside-free, alkaline with pH level 11.7–12.7).

I Disinfect for 5 minutes at a temperature of 93 °C.

I Select an appropriate program according to the above instructions that includes drying. If there is no program with drying, dry the clean parts with a clean cloth or leave to dry on a clean cloth

### Sterilisation

#### Hospital use:

- I Check that the product parts are clean, dry and intact.
- I Wrap the parts in an appropriate sterile packaging.

I Sterilise the parts in the autoclave at 134 °C for 5 minutes. To avoid damage, do not stack or apply external pressure.

### Storage


Put the clean parts in a clean storage bag or a clean environment. It is important that all residual moisture dries. Do not store parts in an airtight container/bag.

### How to use

- I It is recommended that the mother performs her first feedings with the SpecialNeeds Feeder under the supervision of a professional/trained staff.

I Always check the temperature of the liquid before feeding.

### Assembling the feeder

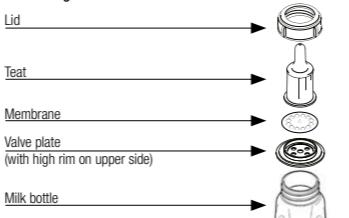

I Hold the valve plate with the high rim facing upwards. Place the white membrane onto the valve plate, inside the rim. Push the membrane's knob completely through the central hole of the valve plate.


I Fill the bottle with the required amount of liquid.

I Place the assembled valve with the high rim upwards onto the bottle opening.

I Place the teat on the valve plate, such that the rim is inside the teat.

I Slide the lid over the teat. Screw all parts together with the lid.

### Filling the teat



I Hold the feeder upright. Squeeze some air out of the teat.


I Keep squeezing while turning the teat upside down.

I Now release the teat. Some liquid will enter it.

I Repeat the above steps until the teat is full. Only put pressure on the part of the teat without liquid.

### Controlling the milk flow

#### slit valve opening

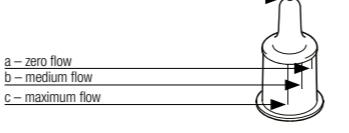

The SpecialNeeds Feeder offers the opportunity to adapt the liquid flow to your infant's needs. Use the lines on the teat to set the liquid flow. The shortest line corresponds to zero flow, the middle line with a medium flow, the largest line for maximum flow.

To select a flow rate, point the corresponding line on the teat towards the infant's nose (see the picture at the right).

Choose zero flow (the shortest line) if the infant needs to get used to the teat before the feeding starts.

### How does the flow rate control mechanism work?

The position of the slit/line in the infant's mouth influences the opening of the slit valve on top of the teat:

- a – zero flow = slit horizontal the pressure keeps the valve closed
- b – medium flow = slit diagonal the valve is partly open for a moderate flow
- c – maximum flow = slit vertical the pressure opens the valve for maximum flow

**Note:** The slit closes between sucks, so that the baby will not be flooded.

**Note:** The feeder supports a sliding flow rate. To get any liquid flow in between zero and maximum, just choose the corresponding position in between the lines.

### Product variants and spare parts

Article nr.	Description
008.0080	Mini SpecialNeeds teat, 25 (hospital)
800.0452	SpecialNeeds teats, 3
800.0453	SpecialNeeds teats, 3
008.0089	SpecialNeeds teat, 25 (hospital)
810.7066	Lid, 1 (hospital)
800.0852	Valve plate complete, 1 (hospital)
800.0625	Bottle, 1 (hospital)

**Material:** Teat and valve membrane: silicone; rest: polypropylene.

**Disposal:** According to local regulations.

**CE 0123**

This symbol indicates compliance with the essential requirements of Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices.

This symbol indicates that the packaging contains products intended to come in contact with food according to regulation 1935/2004.

This symbol indicates to keep the device away from sunlight.

**Hospital use:**

Vor Erstgebrauch – einmal täglich – vor Weitergabe an einen anderen Säugling

I Reinigen Sie den Säugling in seiner Einzelteile. Achten Sie darauf, das gelbe Ventilplättchen vom Säugling zu trennen. Trennen Sie außerdem die weiße Membran vom Ventilplättchen.

**Hinweis:** In der Flasche befindliche Restmilch kann wieder verwendet werden. Im Saugbecken befindliche Restmilch muss jedoch entsorgt werden. Dazu den Säugling über das Spülbecken halten. Vorsichtig den Deckel mit Loch aufschrauben und zusammen mit dem Säugling und dem Ventilplättchen entfernen, damit keine Milch verschüttet wird. Restmilch aus dem Saugbecken entsorgen.

I Alle Teile mit kaltem Wasser (ca. 20 °C) abspülen. Alle Teile mit viel warmem Seifenwasser (ca. 30 °C) reinigen. Verwenden Sie ein handelsübliches Reinigungsmittel, vorzugsweise ohne künstliche Duft- und Farbstoffe (für den Krankenhausgebrauch: 5–15 % anionische Tenside, nichtionische Tenside, pH-neutral).

I Alle Teile mit kaltem Wasser (ca. 20 °C) abspülen.

I Mit einem sauberen Tuch abtrocknen oder auf einem sauberen Tuch trocknen lassen.

I Alternativ das Produkt in der Spülmaschine reinigen. Die Teile sollten ins obere Gitter oder ins Besteckfach gelegt werden. Verwenden Sie ein handelsübliches Geschirrspülmittel.

**Verwendung im Krankenhaus:**

Vor Erstgebrauch – einmal täglich – vor Weitergabe an einen anderen Säugling

I Reinigen Sie den Säugling gemäß der Beschreibung unter "Nach jedem Gebrauch".

I Desinfizieren Sie den Säugling gemäß der Beschreibung unter "Desinfektion".

**Verwendung im Krämerhaus:**

Vor Erstgebrauch – einmal täglich – vor Weitergabe an einen anderen Säugling

I Reinigen und desinfizieren Sie den Säugling gemäß der Beschreibung unter "Desinfektion".

I Falls gemäß nationalen, regionalen oder internen Richtlinien erforderlich, sterilisieren Sie den Säugling gemäß der Beschreibung unter "Sterilisation".

**Desinfektion:**

**Verwendung zu Hause:**

I Alle Teile mit Wasser bedecken und fünf Minuten lang auskochen.

I Oder einen Quick Clean Mikrowellenbeutel gemäß Gebrauchsanweisung verwenden.

I Mit einem sauberen Tuch abtrocknen oder auf einem sauberen Tuch trocknen lassen.

**Verwendung im Krankenhaus:**

I Reinigen und desinfizieren Sie alle Teile in einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät. Verwenden Sie für kleine Teile geeignete Einsätze. Verwenden Sie ein handelsübliches Reinigungsmittel für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte (NTA-frei, phosphatfrei, chlorfrei, tensidfrei, alkalin mit pH-Wert 11,7–12,7).

I Desinfizieren Sie fünf Minuten lang bei einer Temperatur von 93 °C.

I Wählen Sie gemäß den vorigen Anweisungen ein geeignetes Programm aus, welches das Trocknen beinhaltet. Wenn kein Programm inklusive Trocknen vorhanden ist, trocknen Sie die gereinigten Teile mit einem sauberen Tuch ab oder lassen Sie diese auf einem sauberen Tuch trocknen.

**Sterilisation:**

**Verwendung im Krankenhaus:**

I Überprüfen Sie, ob alle Produktteile sauber, trocken und intakt sind.

I Umrwickeln Sie die Teile mit einer geeigneten sterilen Verpackung.

I Alle Teile im Autoklav bei 134 °C fünf Minuten lang sterilisieren. Um Schäden zu verhindern, Teile nicht stapeln und keinen äußeren Druck darauf ausüben.

**Aufbewahrung:**

Legen Sie die sauberen Teile in einen sauberen Aufbewahrungsbeutel oder an einen sauberen Ort. Es ist wichtig, dass alle feuchten Stellen trocknen. Bewahren Sie die Teile nicht in einem luftdichten Behälter Beutel auf.

**Anwendung:**

I Es wird empfohlen, dass die Eltern die ersten Füttermahlzeiten mit dem SpecialNeeds Sauger unter der Aufsicht einer Fachkraft/ geschulten Personals durchführen.

I Überprüfen Sie vor dem Füttern immer die Temperatur der Flüssigkeit.

**Intended use**

The SpecialNeeds Feeder is intended to feed breast milk and other liquids of similar consistency to infants.

The Mini SpecialNeeds Feeder (Mini SNF) has the same intended use as the SpecialNeeds Feeder but for smaller or premature infants.

## Istruzioni per l'uso SpecialNeeds™ tettarella

## Gebruiksaanwijzing SpecialNeeds™ Feeder

## Kullanım talimatları SpecialNeeds™ Biberon

### Destinazione d'uso

La tettarella Special Needs è concepita per somministrare ai neonati latte materno e altri liquidi di consistenza simile.

La tettarella Mini SpecialNeeds (Mini SNF) è stata ideata per lo stesso uso della tettarella SpecialNeeds, ma è destinata a neonati più piccoli o prematuri.

La tettarella Mini SpecialNeeds (Mini SNF) è disponibile soltanto per gli ospedali.

### Indicazioni

La tettarella SpecialNeeds è indicata per l'uso con neonati con i debilità fisica quale, ad esempio ridotto tono muscolare; i disturbi neurologici, cardiaci o respiratori che provochino difficoltà nel coordinamento di suzione, ingestione e respirazione; anomalie orofacciali quali labbro leporino e palatoschisi; o anchiglossia; Sindrome di Pierre Robin o Sindrome di Down.

### Importanti informazioni di sicurezza

Per la sicurezza e la salute del neonato - AVVERTENZA!

I Usare questo prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.

I Non riscaldare il latte in un forno a microonde poiché ciò può causare un riscaldamento non uniforme e ustionare il neonato.

### Leggere le istruzioni prima dell'uso

I Usare il prodotto solo per l'uso a cui è destinato, descritto nel presente manuale di istruzioni.

I L'uso da parte di più neonati senza una rigenerazione adeguata può presentare un rischio per la salute e potrebbe provocare una contaminazione crociata.

I Utilizzare esclusivamente accessori originali Medela.

I Controllare prima di ogni utilizzo. Gettare al primo segnale di danneggiamento, muffa o usura.

I Non lasciare mai la confezione e i componenti incustoditi. Tenerli fuori dalla portata dei bambini.

### CONSERVARE QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONI

I Le bottiglie e i componenti in plastica diventano fragili se congelate e potrebbero rompersi cadendo.

I Inoltre, le bottiglie e i componenti potrebbero danneggiarsi se non maneggiati correttamente, ad esempio se vengono fatti cadere, se serrati eccessivamente o rovesciati.

I Prestare la dovuta attenzione quando si maneggiano le bottiglie e i componenti.

I Non utilizzare il liquido se le bottiglie o i componenti sono danneggiati.

### Pulizia

**Importante**  
I Per la pulizia, usare esclusivamente acqua potabile.

I Rigenerare tutte le parti prima del primo utilizzo (vedere sotto).

I Lavare tutte le parti subito dopo l'uso.

I Le seguenti istruzioni di pulizia sono di carattere generale.

Per le norme e le linee guida specifiche di ogni paese, consultare l'agente Medela o visitare il nostro sito web ([www.medela.com](http://www.medela.com)).

### Dopo ogni uso

I Smontare il biberon nei singoli componenti. Assicurarsi che la valvola sia separata dalla tettarella. Separare anche la membrana bianca dal supporto della valvola.

**Nota:** È possibile riutilizzare il latte rimasto nella bottiglia, ma è necessario smaltire quello rimasto nella tettarella. Tenere il biberon sopra il lavello. Svitare delicatamente il coperchio e rimuoverlo insieme alla tettarella e al supporto della valvola, per evitare che il latte fuoriesca. Gettare il latte rimasto all'interno della tettarella.

I Risciacquare tutti i componenti con acqua fredda (20 °C circa). Pulire tutti i componenti con abbondante acqua saponata tiepida (30 °C circa). Utilizzare un comune detergente per stoviglie, preferibilmente senza profumi e coloranti artificiali (per uso ospedaliero: 5-15% tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, pH neutro). Risciacquare tutti i componenti con acqua fredda (20 °C circa).

I Asciugare con un panno pulito o lasciare asciugare su un panno pulito.

I In alternativa, lavare il prodotto in lavastoviglie. Posizionare i componenti nel cestello superiore o nello scomparto per le posate. Utilizzare un normale detergente per lavastoviglie.

### Uso domestico:

**Prima del primo uso e una volta al giorno**

I Lavare il biberon come descritto nella sezione «Dopo ogni utilizzo».

I Disinfettare il biberon come descritto nella sezione «Disinfettazione».

### Disinfettazione:

#### Uso domestico:

I Coprire tutti i componenti con acqua e lasciare bollire per cinque minuti.

I In alternativa, utilizzare una sacca per microonde Quick Clean seguendone le istruzioni.

I Asciugare con un panno pulito o lasciare asciugare su un panno pulito.

#### Uso ospedaliero:

I Lavare e disinsettare tutti i componenti in una disinsettatrice meccanica. Inserire inserti adeguati per i componenti più piccoli. Utilizzare un comune detergente per disinsettatori (privi di NTA, fosfati, cloro e tensioattivi, alcalino e con pH compreso tra 11,7 e 12,7).

I Disinfettare per cinque minuti alla temperatura di 93 °C.

I Selezionare un programma rispondente alle indicazioni sopra riportate e che prevede l'asciugatura. Qualora non sia disponibile alcun programma con asciugatura, asciugare i componenti puliti con un panno pulito o lasciarli asciugare su un panno pulito.

### Sterilizzazione:

#### Uso ospedaliero:

I Verificare che i componenti del prodotto siano puliti, asciutti e integri.

I Avvolgere i componenti con un imballaggio adeguato e sterile.

I Sterilizzare tutti i componenti in autoclave a 134 °C per 5 minuti. Per evitare danni, non imprimere o applicare pressione dall'esterno.

### Conservazione:

Riporre i componenti detesi in una borsa di conservazione o in un ambiente pulito. È importante far asciugare tutta l'umidità residua. Non conservare i componenti in contenitori/borse a chiusura ermetica.

### Informazioni sull'utilizzo

I Si suggerisce che la tettarella SpecialNeeds venga utilizzata per le prime volte sotto la supervisione di un professionista adeguatamente formato.

I Controllare sempre la temperatura del liquido prima di somministrarlo al neonato.

### Montaggio del biberon




- I Tenere il supporto della valvola con il bordo rialzato rivolto verso l'alto. Collocare la membrana bianca sul supporto della valvola all'interno del bordo. Premere la manopola della membrana fino a farla entrare completamente nel foro centrale del supporto della valvola.
- I Introdurre la quantità stabilita di liquido nella bottiglia.
- I Collocare la valvola montata sulla bocca della bottiglia, assicurandosi che il bordo rialzato sia rivolto verso l'alto.
- I Far scorrere il coperchio sulla tettarella. Attivare tutti i componenti con il coperchio.

### Riempire la tettarella



- I Tenere il biberon in posizione verticale. Schiacciare fuori un po' d'aria dalla tettarella.
- I Tenere la tettarella schiacciata e rovesciare il biberon.
- I Rilasciare la tettarella. Un po' di liquido entrerà nella tettarella.
- I Ripetere i passi descritti finché la tettarella è completamente piena. Eseguire pressione solo sulla parte della tettarella che non contiene liquido.

### Controllo del flusso del latte



La tettarella SpecialNeeds permette di adattare il flusso del liquido alle esigenze del bambino. Utilizzare le linee sulla tettarella per regolare il flusso del liquido: la linea più corta in caso di assenza di flusso, la linea di mezzo per il flusso medio, la linea più lunga per il flusso massimo. Per selezionare il flusso, puntare la linea corrispondente sulla tettarella in direzione del naso del neonato (si veda il disegno a destra). Usare la linea per assenza di flusso (la più corta) se il neonato deve abituarsi alla tettarella prima di iniziare a succhiare.

Come funziona il meccanismo di controllo del flusso? La posizione della tettarella/linea nella bocca del neonato influisce sull'apertura della valvola sulla fessura della tettarella:

- a - assenza di flusso = fessura orizzontale, la pressione mantiene chiusa la valvola
- b - flusso medio = fessura in diagonale, la valvola è parzialmente aperta per il flusso moderato
- c - flusso massimo = fessura verticale, la pressione mantiene la valvola per il flusso massimo

**Nota:** La fessura si chiude tra i cicli di suczione, in modo tale che non arrivi mai troppo latte nella bocca del bambino.

**Nota:** La tettarella consente di variare il flusso. Per avere qualsiasi flusso compreso tra il minimo e il massimo, si sceglia la posizione corrispondente tra le linee.

### Varianti del prodotto e ricambi

N. articolo	Descrizione
008.0080	Tettarella Mini SpecialNeeds, 25 (ospedale)
800.0452	tettarella SpecialNeeds, 3
800.0453	tettarella SpecialNeeds, 3
008.0089	tettarella SpecialNeeds, 25 (ospedale)
810.7066	Coperchio, 1 (ospedale)
800.0852	Supporto della valvola completo, 1 (ospedale)
800.0625	Bottiglia, 1 (ospedale)

**Materiale:** Tettarella e membrana della valvola: silicone; resto: polipropilene.

**Smaltimento:** conformemente alle disposizioni locali.

Questo simbolo indica la conformità ai requisiti fondamentali della Direttiva 93/42/CE del 14 giugno 1993 relativa ai dispositivi medici.

Questo simbolo indica che la confezione contiene prodotti destinati a venire a contatto con alimenti secondo il regolamento 1935/2004.

Questo simbolo indica che il dispositivo non deve essere esposto alla luce solare.



0123

Questo simbolo indica la conformità ai requisiti fondamentali della Direttiva 93/42/CE del 14 giugno 1993 relativa ai dispositivi medici.

Questo simbolo indica che la confezione contiene prodotti destinati a venire a contatto con alimenti secondo il regolamento 1935/2004.

Questo simbolo indica che il dispositivo non deve essere esposto alla luce solare.



0123

Questo simbolo indica la conformità ai requisiti fondamentali della Direttiva 93/42/CE del 14 giugno 1993 relativa ai dispositivi medici.

Questo simbolo indica che la confezione contiene prodotti destinati a venire a contatto con alimenti secondo il regolamento 1935/2004.

Questo simbolo indica che il dispositivo non deve essere esposto alla luce solare.



0123

Questo simbolo indica la conformità ai requisiti fondamentali della Direttiva 93/42/CE del 14 giugno 1993 relativa ai dispositivi medici.

Questo simbolo indica che la confezione contiene prodotti destinati a venire a contatto con alimenti secondo il regolamento 1935/2004.

Questo simbolo indica che il dispositivo non deve essere esposto alla luce solare.



0123

Questo simbolo indica la conformità ai requisiti fondamentali della Direttiva 93/42/CE del 14 giugno 1993 relativa ai dispositivi medici.

Questo simbolo indica che la confezione contiene prodotti destinati a venire a contatto con alimenti secondo il regolamento 1935/2004.

Questo simbolo indica che il dispositivo non deve essere esposto alla luce solare.



0123

### Beoogd gebruik

De SpecialNeeds Feeder is bedoeld om moedermelk en andere vloeistoffen met een vergelijkbare consistente aan baby's te geven.

Het beoogd gebruik van de Mini SpecialNeeds Feeder (Mini SNF) is hetzelfde als van de SpecialNeeds Feeder, maar bedoeld voor kleineren of premature baby's. De Mini SNF is alleen beschikbaar voor ziekenhuizen.

### Indicaties

De SpecialNeeds Feeder is speciaal bedoeld voor baby's met:

- I Een zwakke conditie zoals een lage spierspanning;
- I Neurologische afwijkingen of aandoeningen aan het luchtwegen die resulteren in moeilijkheden bij het coördineren van zuigen, slikken en ademen;
- I Afwijkingen aan mond of gezicht zoals een gespleten lip/verhemelte of een korte tongriem;
- I Pierre Robin syndroom of Down-syndroom.